

機械器具52医療用拡張器  
管理医療機器 カテーテル拡張器 32338000

## クリニーイントロデューサーシステム (ダイレーター)

再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済である。

### 【形状】

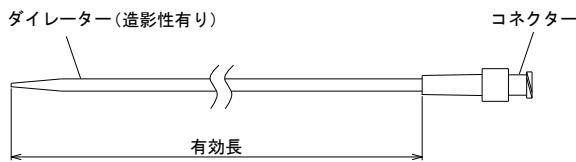

下記の一覧表に記した規格は弊社規格品の仕様である。特注品の製品規格については、個包装に記載された規格を参照すること。

サイズ呼称	外径	有効長
5Fr	1.7mm	
6Fr	2.1mm	
7Fr	2.3mm	
8Fr	2.6mm	
9Fr	2.9mm	
10Fr	3.3mm	
11Fr	3.6mm	
12Fr	3.9mm	
13Fr	4.2mm	
14Fr	4.6mm	
15Fr	4.9mm	
16Fr	5.3mm	

203mm

### 【原材料】

ポリエチレン

### 【原理】

本品は穿刺針、メス等により開口した体表部にダイレーターを挿入することで、開口部が拡張又は拡大するためにカテーテル又はガイドワイヤーを挿入することができる。

### 【使用目的又は効果】

カテーテル又はガイドワイヤーの導入又は操作のために、内腔又は開口部を拡張又は拡大するために用いる用具。本品は胃瘻用、胆道瘻孔用、腎瘻用に用いる。

### 【操作方法又は使用方法等】

以下の使用方法は一般的な使用方法である。

- ①手技にしたがって目的部位にガイドワイヤーを留置する。(対応するガイドワイヤーについては、**組み合わせて使用する医療機器**の項を参照のこと。)
- ②ガイドワイヤーに沿わせて本品を挿入し、刺入部を拡張する。
- ③本品を抜去する。

### 【組み合わせて使用する医療機器】

本品を使用する際は、以下の医療機器と組み合わせて使用すること。

サイズ呼称	推奨ガイドワイヤー外径
5Fr	0.89mm(0.035")
6Fr～16Fr	0.97mm(0.038")

### 【使用方法等に関する使用上の注意】

- ①本品を使用する場合は、超音波画像下又はX線透視下にて手技を実施すること。
- ②本品の挿入操作は慎重に行い、スムーズに挿入できなくなった場合は、必要以上に押し込まないこと。特にPTCDに使用する場合は、胆管穿刺時及び穿刺後に必要以上に本品を押し込まないように、慎重に操作すること。このような場合はガイドワイヤーとの併用が望ましい。  
〔挿入部が屈曲していたり、硬質部位に当たったりすることで、ダイレーター先端が変形する可能性があり、その状態で無理に押し込むと、製品の破損及び組織の損傷を引き起こす恐れがある。〕

### 【使用上の注意】

#### 【重要な基本的注意】

本品を鉗子等で強く掴まないこと。

### 【不具合・有害事象】

#### 【その他の不具合】

ダイレーターの捲れ、折れ、曲がり、損傷、切断。

- 〔下記のような原因により捲れ、折れ、曲がり、損傷、切断の恐れがある。〕
- ・無理な挿入、抜去、過度のトルク操作等。
  - ・屈曲した部位、硬質部位への挿入。
  - ・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。

#### 【その他の有害事象】

本品の使用により、以下の有害事象が発症する恐れがある。

- ・損傷(穿孔等)
- ・出血

### 【妊娠、産婦、授乳婦及び小児等への適用】

妊娠している、あるいはその可能性がある患者にX線を使用する場合は、注意すること。

〔X線による胎児への影響が懸念される。〕

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避けて清潔に保管すること。

### 【有効期間】

適正な保管方法が保たれていた場合、個包装に記載の使用期限を参照のこと。

〔自己認証(当社データ)による。〕

### 【使用期間】

本品の使用期間は24時間以内である。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

クリエートメディア株式会社

電話番号 : 0120-853598\*